







# Afficheurs de pression acoustique

Mesure et analyse des risques auditifs





Chaque afficheur de niveau acoustique figuratif avec un capteur de pression acoustique intégré, vendu est scrupuleusement vérifié sur les caractéristiques suivantes :

- Réponse en fréquence
- Linéarité
- Pondération fréquentielle A C Z
- Bruit de fond

Un certificat d'étalonnage unique est disponible en téléchargement sur notre site internet .

Muni du numéro de série de l'appareil, rendez-vous à l'adresse : <a href="https://www.sonectra.com/certificat-de-calibration/">https://www.sonectra.com/certificat-de-calibration/</a> pour le télécharger, ou scannez le QR code ci-dessous :







## SOMMAIRE

$\Rightarrow$	Description	4
$\Rightarrow$	Synoptique	7
$\Rightarrow$	Face avant DBM103i, DBM303i	8
$\Rightarrow$	Face avant DBM203i, DBM403i, DBM403i Mobil, DBM603i	9
$\Rightarrow$	Face arrière DBMseries	12
$\Rightarrow$	Intégration	22
$\Rightarrow$	DBM403i Mobil	24
$\Rightarrow$	Guide d'installation	30
$\Rightarrow$	Procédure de mise à jour	32
$\Rightarrow$	Caractéristiques	33
$\Rightarrow$	Serveur web	34
$\Rightarrow$	Annexe : outils techniques	45

La gamme DBMseries - version industrielle - sont une solution avancée de suivi et d'affichage des niveaux de pression acoustique en temps réel.

Afin d'apporter un support fiable au suivi des niveaux sonores, les DBMseries - version industrielle - ont la particularité de pouvoir changer de couleur suivant des seuils définis au préalable et sur une large palette de couleurs.

#### DBM203i: Sonomètre intégrateur - Serveur web embarqué - IP connexion

- Le sonomètre intégrateur est conforme à la classe 2 selon la norme IEC61672-1 de mars 2014.
- Visualisation sur trois afficheurs programmables indépendamment en pondération A ou C, en Leq1s, 1min, 5min, 10min, 15min, 60min et en LpC.
  - Chaque afficheur est configurable en couleur de base et en fonction des dépassements.
- Un indicateur prédictif de tendance à 9 niveaux, basé sur le Leq1min permet de gérer au mieux la gestion sonore et d'agir souplement et avec anticipation pour éviter les dépassements du Leq 10min ou 15min.
- Deux sorties relais GPO1 et GPO2 (sur RJ45) permettent le déclenchement d'une alarme ou une signalisation extérieure.
  - Choix pour chaque GPO de la pondération A ou C et du Leq1s,1min,10min ou 15min.
- La consultation et la programmation sont réalisées par le port LAN (IP).
- Intégration dans le DBM203i d'un serveur web embarqué, permettant la configuration et la consultation en temps réel des niveaux sonores. La liaison sous la forme IP fonctionne avec n'importe quel OS, n'importe quel navigateur et surtout sans avoir à télécharger un logiciel spécifique.
- Fonctionnement seul ou en réseau.
- Fourni avec un pied rotule pour permettre l'orientation idéale.
- Alimentation 12V fournie.
- Dimensions DBM203 : 265 x 150 x 35 mm

#### DBM103i: Sonomètre intégrateur - Serveur web embarqué - IP connexion

Le sonomètre intégrateur est conforme à la classe 2 selon la norme IEC61672-1 de mars 2014.

Il reprend toutes les fonctions du DBM203i avec une visualisation sur un seul afficheur programmable en pondération A ou C en Leq1s, 1min, 5min, 10min, 15min, 60min ainsi qu'en LpC max 1min.

**DESCRIPTION** Suite

## DBM403i: Sonomètre intégrateur et enregistreur - Serveur web embarqué - IP connexion.

Le sonomètre intégrateur est conforme à la classe 2 selon la norme IEC61672-1 de mars 2014.

Il reprend les fonctions de DBM203i avec en plus l'enregistrement des niveaux sonores.

Enregistrement en continu des niveaux sonores en décibels pondérés A et C, sous la forme LAeq1min, 5min, 10min, 15min, 60min et LCeq1min, 5min, 10min, 15min, 60min glissant par pas de 1min, ainsi que le LpC max 1min et LAF max 1min.

La mémoire interne est dimensionnée pour stocker ces valeurs de niveaux sonores 24H sur 24 et 7 jours sur 7 pendant 6 mois.

## DBM303i: Sonomètre intégrateur et enregistreur - Serveur web embarqué - IP connexion

Le sonomètre intégrateur est conforme à la classe 2 selon la norme IEC61672-1 de mars 2014.

Il reprend toutes les fonctions de DBM403i avec une visualisation sur un seul afficheur programmable en pondération A ou C en Leg1s, 1min, 5min, 10min, 15min, 60min ainsi qu'en LpC max 1min.

## DBM603i : Sonomètre intégrateur et enregistreur - 8 heures - Serveur web embarqué - IP connexion

Le sonomètre intégrateur est conforme à la classe 2 selon la norme IEC61672-1 de mars 2014.

Il reprend toutes les fonctions de DBM403i avec un enregistreement de leg 8 heures et 16 heures.

**DESCRIPTION** Suite

## DBM403i Mobil: Sonomètre intégrateur - Serveur web embarqué - IP connexion.

Le sonomètre intégrateur est conforme à la classe 2 selon la norme IEC61672-1 de mars 2014.

Visualisation sur trois afficheurs programmables indépendamment en pondération A ou C, en Leq1s,1min, 5min, 10min, 15min, 60min et en LpC. Chaque afficheur est configurable en couleur de base et en fonction des dépassements.

Un indicateur prédictif de tendance à 9 niveaux, basé sur le Leq1 min permet de gérer au mieux la gestion sonore et d'agir souplement et avec anticipation pour éviter les dépassements du Leq 10 min ou 15 min.

Deux sorties relais GPO1 et GPO2 (sur RJ45) permettent le déclenchement d'une alarme ou une signalisation extérieure. Choix pour chaque GPO de la pondération A ou C et du Leq1s, 1 min, 10 min ou 15 min.

Intégration d'un serveur web embarqué, permettant la configuration et la consultation en temps réel des niveaux sonores. La liaison sous la forme IP fonctionne avec n'importe quel OS, n'importe quel navigateur et surtout sans avoir à télécharger un logiciel spécifique.

Fonctionnement seul ou en réseau.


Enregistrement en continu des niveaux sonores en décibels pondérés A et C, sous la forme LAeq1min, 5min, 10min, 15min, 60min et LCeq1min, 5min, 10min, 15min, 60min glissant par pas de 1min, ainsi que le LpC max 1min et LAF max 1min.


La mémoire interne est dimensionnée pour stocker ces valeurs de niveaux sonores 24H sur 24 et 7 jours sur 7 pendant 6 mois.

#### Le DBM403i Mobil est plus particulièrement étudié pour les mesures ponctuelles.

L'alimentation s'effectue par une prise schuko, le ou les capteurs se raccordent en XLR, le réseau peut se connecter en etherCON. Il est doté d'un insert 3/8 ème de pouce sur la face inférieure pour pouvoir le positionner sur un pied de micro et d'un autre sur la face supérieure pour fixer la pince du capteur. Quatre inserts M4 permettent la fixation par un pied au standard vesa.

Il peut fonctionner soit, avec un seul capteur pour la mesure à la fois en pondération A et C, soit avec deux capteurs pour la mesure en pondération A et C séparément. Ce dernier cas permet de positionner les capteurs à l'endroit, où le niveau sonore est le plus fort en fonction de la pondération.

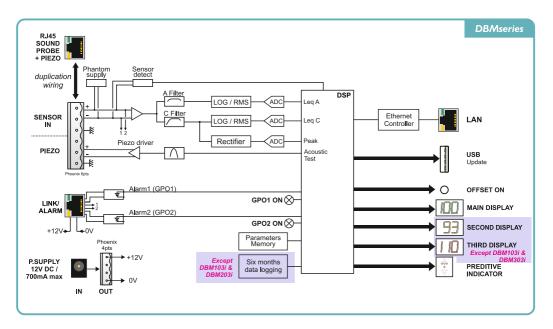

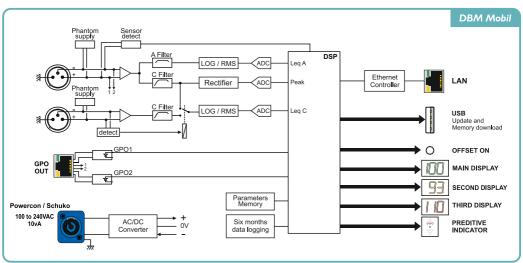



A - Indicateur prédictif de tendance sur neuf niveaux, basé sur le Leq1min.

## Comparaison par rapport au niveau de consigne lea max

C	lign	oter	nent

0 0 0 0 0 0	0 00 000	0 00 000	0 00 000	0 00 000	0 0 0 0 0	000	000	0 0 0 0 0 0
0	0	0	0	0	0	0	0	•
000	000	0 0 0 0 0	000	000	000	000	000	000
Leq1min<-3dB	Leq1min<-2dB	Leq1min<-1dB	-1dB <leq1min<0db< th=""><th>IdB&gt;LeqImin&gt;OdB</th><th>Leq1min&gt;1dB</th><th>Leq1min&gt;2dB</th><th>Leq1min&gt;3dB</th><th>Leq1min&gt;4dB</th></leq1min<0db<>	IdB>LeqImin>OdB	Leq1min>1dB	Leq1min>2dB	Leq1min>3dB	Leq1min>4dB

**B** - Affichage central de 120 x 70 mm

Affichage principal paramétrable en pondération A ou C. La moyenne affichée est sélectionnable dans la liste suivante à l'aide du serveur web :

Leq1 seconde pondéré A ou C.

Lea1 minute pondéré A ou C.

Leg5 minutes pondéré A ou C.

Leg10 minutes pondéré A ou C.

Leg15 minutes pondéré A ou C.

Leq 60 minutes pondéré A ou C.

Il permet aussi l'affichage des codes d'erreurs.

Cet afficheur peut changer de couleur en fonction des niveaux sonores (voir remarque ci-dessous)

- **C-** Cet indicateur Offset permet de savoir si une correction de mesure a été appliquée en fonction de la position du microphone par rapport à la zone public.
- **D** Cellule photo-électrique associée au réglage automatique de la luminosité.
- **E** Indication de la pondération A, C choisie pour l'afficheur central B.

**Remarque**: Exemples de changement de couleur en fonction du niveau sonore.

Les couleurs sont paramétrables de base et en fonction des deux seuils hauts.



Les niveaux sont en-dessous du premier seuil paramétrable



A - Indicateur prédictif de tendance sur neuf niveaux, basé sur le Leq1min.

#### Comparaison par rapport au niveau de consigne leg max

_	
- (.)	ignotement
-	.6

0 0 0 0 0 0	0 00 000	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 00 000	0 0 0 0 0	000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
0	0	0	0	٥	0	٥	٥	۰
000	000	000	000	000	000	000	000	000
Leq1min<-3dB	Leq1min<-2dB	Leq1min<-1dB	-1dB <leq1min<0db< th=""><th>IdB&gt;LeqImin&gt;OdB</th><th>Leq1min&gt;1dB</th><th>Leq I min &gt; 2dB</th><th>Leq1min&gt;3dB</th><th>Leq1min&gt;4dB</th></leq1min<0db<>	IdB>LeqImin>OdB	Leq1min>1dB	Leq I min > 2dB	Leq1min>3dB	Leq1min>4dB

**B** - Affichage central de 120 x 70 mm

Affichage principal paramétrable en pondération A ou C. La moyenne affichée est sélectionnable dans la liste suivante à l'aide du serveur web:

Leg1 seconde pondéré A ou C.

Lea1 minute pondéré A ou C.

Leg5 minutes pondéré A ou C.

Leg10 minutes pondéré A ou C.

Leg15 minutes pondéré A ou C.

Leq 60 minutes pondéré A ou C.

Il permet aussi l'affichage des codes d'erreurs.

Cet afficheur peut changer de couleur en fonction des niveaux sonores (voir remarque ci-dessous)

- **C-** Cet indicateur Offset permet de savoir si une correction de mesure a été appliquée en fonction de la position du microphone par rapport à la zone public.
- **D** Affichage de 55 x 35 mm :

Deuxième Affichage, paramétrable en pondération A ou C. La moyenne affichée est sélectionnable dans la liste suivante à l'aide du serveur web:

Leq 1 seconde pondéré A ou C.

Leg 1 minute pondéré A ou C.

Leg 5 minutes pondéré A ou C.

Leg 10 minutes pondéré A ou C.

Leg 15 minutes pondéré A ou C.

Leg 60 minutes pondéré A ou C.

LpC

Cet afficheur peut changer de couleur en fonction des niveaux sonores (voir remarque ci-dessous)



- **E** Indication de la pondération A, C ou Lpc choisie pour cet afficheur D
- F Indication du Leq10 min ou 15 min choisi pour cet afficheur D. Sans indication le Leq est autre.
- G Affichage de 55 x 35 mm :

Troisième Affichage, paramétrable en pondération A ou C. La moyenne affichée est sélectionnable dans la liste suivante à l'aide du serveur web:

Leg 1seconde pondéré A ou C.

Leg 1 minute pondéré A ou C.

Leg 5minutes pondéré A ou C.

Leg 10minutes pondéré A ou C.

Leg 15minutes pondéré A ou C.

Leg 60minutes pondéré A ou C.

LpC

Cet afficheur peut changer de couleur en fonction des niveaux sonores (voir remarque ci-dessous).

- **H** Indication de la pondération A, C ou LpC choisie pour cet afficheur G.
- I- Indication du Leq 10 min ou 15 min choisie pour cet afficheur G. Sans indication le Leq est autre.
- J Cellule photo-électrique associée au réglage automatique de la luminosité.
- **K** Indication de la pondération A, C choisie pour l'afficheur central B.

## **Remarque:** Exemples de changement de couleur en fonction du niveau sonore.

Les couleurs sont paramétrables de base et en fonction des deux seuils hauts. Les seuils sont paramétrables séparément pour chaque afficheur.



Les niveaux sont en-dessous du premier seuil paramétrable



Idem mais le LCeq a dépassé le premier seuil




Le LAeq et le LCeq ont dépassé le premier seuil




Le LAeq a dépassé le premier seuil et le LCeq a dépassé le deuxième seuil paramétrable




Le Leq1s a dépassé le deuxième seuil

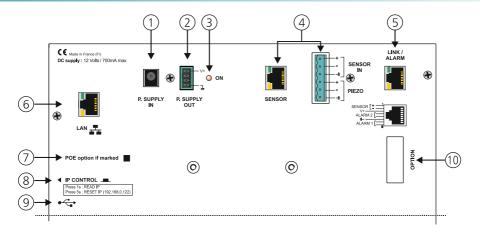

I - Embase pour connecter l'alimentation extérieure 12V fournie

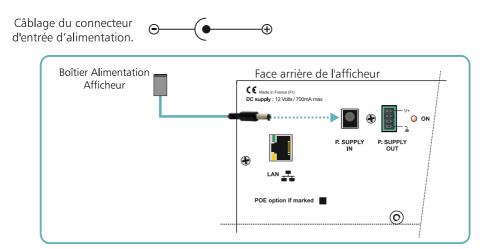


2 - Embase 4 points mâle débrochable de sortie d'alimentation 12V




3 - Témoin de mise sous tension

4 - Embase 6 points mâle pour la connexion d'un capteur.

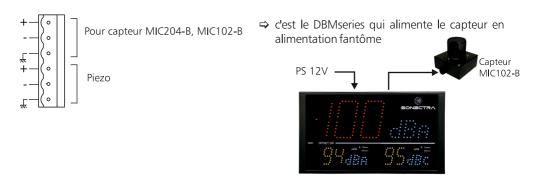

Le MIC102 est testé à la fois en continuité de câblage symétrique et en acoustique :

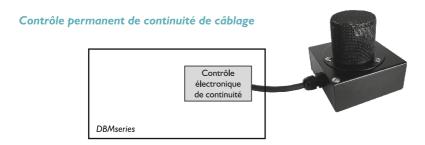

## Test d'intégrité du capteur

Ce test d'intégrité acoustique n'est fonctionnel qu'avec le capteur MIC102.

Si vous utilisez un MIC102, il faut désactiver cette fonction dans le serveur web. Voir page 39 Ne câblez alors que les trois premiers points sur le connecteur 6 points référencé 4 en face arrière.




## La protection du MIC102 :


Protection du capteur contre l'humidité et la poussière par bonnettes, et protection mécanique par capot maille inox perméable acoustiquement.



## 4. I - Câblage avec le connecteur 6 points

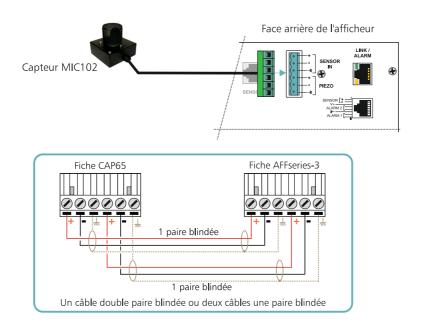


## 4.2 - Câblage avec le connecteur RJ45

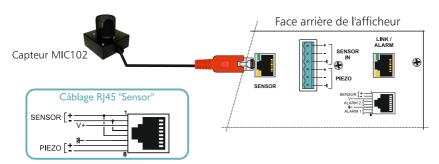


Led verte en haut : Cette led signale que le capteur est branché soit sur la RJ45 Sensor, soit sur le bornier 6 points et que la liaison est correcte.


*Led jaune en bas* : Cette led signale la mise en route du test acoustique du capteur.



## 4.3 - Câblage de deux afficheurs en autonome

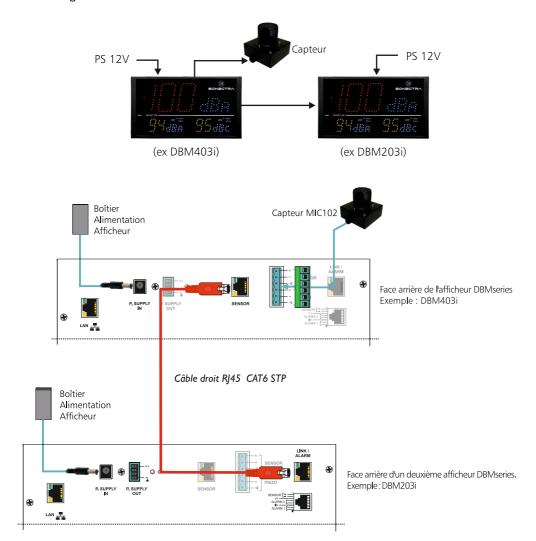

## 4.4 - Câblage avec afficheur figuratif et pédagogique, AMIseries

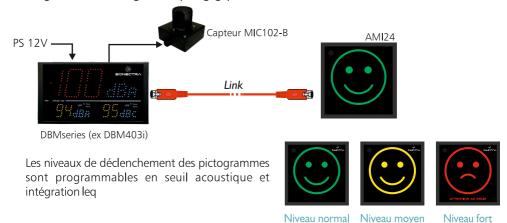

Boîtier Alimentation Afficheur

Capteur MIC120-B

Câble droit RJ45 CAT6 STP

Link

Face arrière de DBMseries

Boitier Alimentation
12V

Face arrière AMlxx\_SC

Dc supply

Sensor

L'alimentation est fournie avec un connecteur câblé et un cordon de I m80. Vous pouvez le prolonger jusqu'à 5 m avec un câble de 0,75mm², jusqu'à 25 m avec un câble I,5mm² et jusqu'à 50m avec un câble de 2,5mm²


Pour alimenter l'ensemble, reliez les deux afficheurs (DBMseries et AMIxx SC) aux alimentations fournies.

Reliez l'afficheur DBMseries et l'AMIxx\_SC avec un câble RJ45 (câblage droit). Connectez le capteur (exemple MIC102) à l'afficheur DBMseries.


Chaque afficheur a une alimentation indépendante.

à fort

**5 -** Embase RJ45 contenant des sorties GPO sur relais OPTO MOS qui correspondent aux dépassements du niveau d'alarme.



Les Leds ALARM I et ALARM2 visualisent l'état des Alarmes.



## Remarque:

Chaque OPTO MOS peut être assimilé à un relais et en possède tous les avantages (signaux alternatifs possibles, pas de polarisation). Une limitation en courant est incluse et fixée à 200mA.

#### Attention:

Ne pas connecter d'ordinateur sur cette prise, sur-risque de dommages sur votre carte réseau.


Les sorties relais Alarm1 et Alarm2 permettent aussi de déclencher un enregistreur audio avec horodatage (équipement non fourni).

Cela permet en cas de dépassement de la valeur de consigne, d'identifier le niveau sonore mis en cause, musique ou bruit du public (applaudissements, cris...)

6 - Embase RJ45 pour la liaison réseau éthernet (LAN)

## 7 - Option PoE

Si l'option est cochée, l'afficheur DBM series comporte en interne l'interface d'alimentation PoE (Power over Ethernet). Cette fonction permet d'alimenter l'équipement directement par le câble réseau, sans avoir besoin d'alimentation 12 Volts externe.

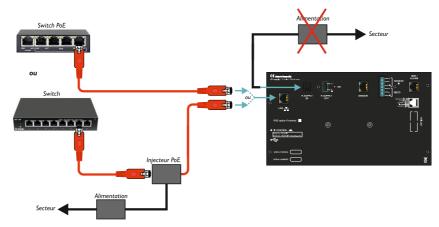

## 8 - IP control: interrupteur fugitif permettant:

Sur un appui de 1 seconde, de visualiser l'adresse IP sur l'afficheur en face avant. Sur un appui de 5 secondes de faire le reset de l'adresse IP et de revenir à l'adresse IP de sortie usine soit 192,168,0,122.

9 - Embase USB permettant le téléchargement de l'historique et la mise à jour de l'afficheur :


Téléchargement : L'appareil étant sous tension , insérez la clé USB. L'afficheur principal indique UP et un affficheur secondaire indique le pourcentage de téléchargement. Enlevez la clé après l'affichage 100%.

Mise à Jour : Coupez l'alimentation 12 Volts, insérez la clé USB avec le fichier de mise à jour, appuyez en permanence sur le switch 8 (IP control) à l'aide d'un outil pointu, remettre l'alimentation 12 Volts. L'afficheur principal indique BO, attendre l'indication 100 % pour enlever la clé USB.




## IO - Option.

Embase Sub-D 9 points femelle RS232 et sortie 0/10V mesurée en pondération A ou C.




## A - Intégration en autonome






## B - Intégration en réseau LAN

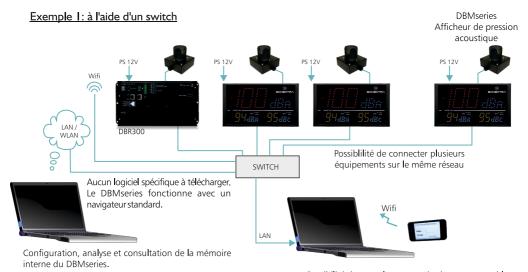


Possibilité de consulter sur un équipement portable (réseau wifi) si le switch dispose de cette option.

INTEGRATION Suite

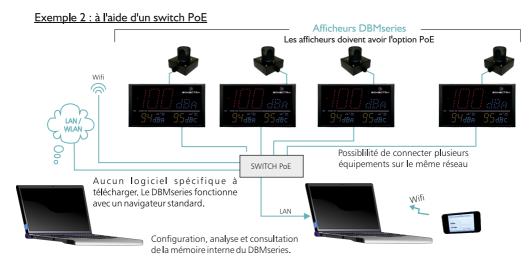


## $\mbox{\bf C}$ - Duplication d'affichage par IP, avec la fonction Client/Serveur UDP

Exemple I: à l'aide d'un switch sans PoE

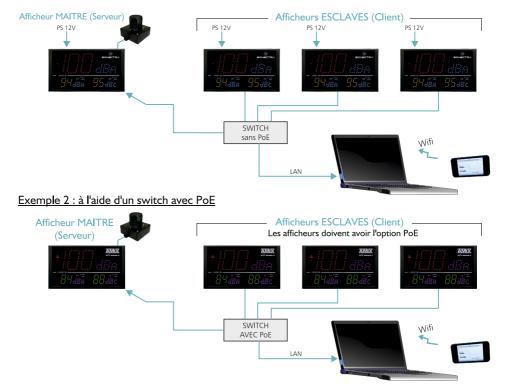



Le MAITRE (serveur) peut être un DBM403i. SEUL le MAITRE (serveur) enregistre les niveaux sonores.

#### A - Face arrière du BDM403i Mobil

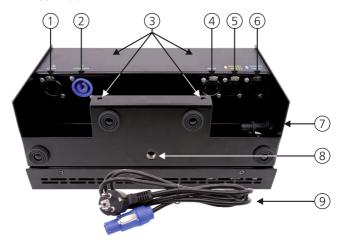

- I Embase RJ45 pour la liaison réseau Ethernet (LAN).
   Peut recevoir les fiches standard RJ45 ou les RJ45 spécifiques EtherCON (catégorie 5E)
   PoE en option.
- 2 Embase entrée secteur de type powercon ; 100 to 240 V AC / 10 VA. Le câble fiche secteur vers Powercon est fourni avec l'équipement
- 3 Quatre écrous noyés M4 pour la fixation d'un pied Vesa 100x100 mm
- **4 -** Embase RJ45 contenant des sorties GPO sur relais OPTO MOS qui correspondent aux dépassements du niveau d'alarme.





#### Remarque:

Chaque OPTO MOS peut être assimilé à un relais et en possède tous les avantages (signaux alternatifs possibles, pas de polarisation). Une limitation en courant est incluse et fixée à 200mA.

 $Attention: Ne\ pas\ connecter\ d'ordinateur\ sur\ cette\ prise,\ sur-risque\ de\ dommages\ sur\ votre\ \ carte\ r\'eseau.$ 

Les sorties relais Alarm1 et Alarm2 permettent aussi de déclencher un enregistreur audio avec horodatage (équipement non fourni).

Cela permet en cas de dépassement de la valeur de consigne, d'identifier le niveau sonore mis en cause, musique ou bruit du public (applaudissements, cris...)

DBM403 Live

**6-** Embase XLR femelle pour la connexion du capteur secondaire pour la pondération C. La détection et la commutation sont automatiques.



Les deux types de capteurs compatibles sont le MIC204 ou le MIC102

Suite

7 - Embase XLR femelle (non connectée) permettant juste de loger le capteur pour le transport.



- 8 Ecrou noyé 3/8 ème de pouce permettant la fixation sur un pied de micro.
- 9 Câble secteur avec Powercon ou Schuko fourni avec l'équipement





**IO -** IP control: interrupteur fugitif permettant:

Sur un appui de 1 seconde , de visualiser l'adresse IP sur l'afficheur en face avant .

Sur un appui de 5 secondes de faire le reset de l'adresse IP et de revenir à l'adresse IP de sortie usine soit 192.168.0.122.

II - Embase USB permettant le téléchargement de l'historique et la mise à jour de l'afficheur :


Téléchargement : L'appareil étant sous tension , insérez la clé USB. L'afficheur principal indique UP et un affficheur secondaire indique le pourcentage de téléchargement. Enlevez la clé après l'affichage 100%.

Mise à Jour : Coupez l'alimentation secteur, insérez la clé USB avec le fichier de mise à jour, appuyez en permanence sur le switch 10 (IP control) à l'aide d'un outil pointu, remettre l'alimentation secteur. L'afficheur principal indique BO, attendre l'indication 100 % pour enlever la clé USB.

DBM403 Live Suite

## B - Montage du DBM403i Mobil



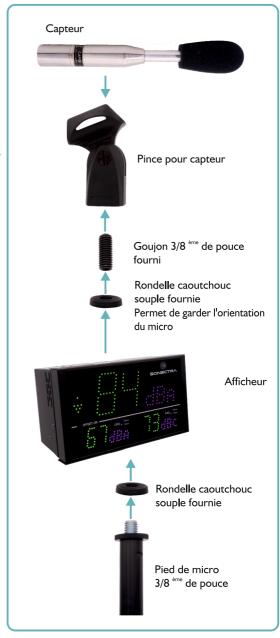

Il est recommandé d'établir tous les raccordements avant de mettre l'appareil sous tension.


#### A/ Branchements:


Branchez le capteur MIC102 à l'afficheur DBMseries

Pour alimenter l'afficheur, connectez le à l'alimentation fournie.

Pour une première utilisation, connectez votre DBMseries directement à votre ordinateur en utilisant son port RJ45 (noté LAN sur la face arrière de l'appareil).

Si vous souhaitez exploiter les boucles sèches de sortie, utilisez un deuxième câble RJ45. Connectez la sortie Alarm1/ Alarm2 de votre DBMseries à un appareil extérieur. Dans le cas contraire, ne rien connecter.

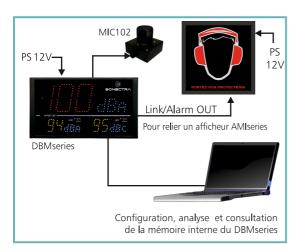



#### B/ Mise en route:

#### ⇒ Utilisation en autonome :

Le DBMseries embarque un serveur web, permettant ainsi de le contrôler avec votre navigateur internet favori. Ouvrez votre navigateur web, tapez l'adresse IP du DBMseries dans la barre d'adresse, puis appuyez sur entrée.

En sortie d'usine l'adresses IP des afficheurs DBMseries est :

http:// 192.168.0.122

Vous pouvez maintenant visualiser les pages web, qui vous permettront de configurer, d'analyser et de consulter la mémoire interne du DBM series.

Attention en cas de difficultés, voir la procédure à suivre en annexe dans "outils techniques".

#### ⇒ Utilisation en réseau :

Utilisez un câble éthernet pour connecter votre DBM series au réseau en utilisant son port RJ45.

Attention: Pour fonctionner correctement l'adresse IP de DBMseries doit être d'une part unique dans le sous réseau, et d'autre part elle doit appartenir à la plage d'adresse IP disponible. Si le PC ou le routeur, sur lequel DBMseries est branché, est dans un autre sous réseau, il faudra mettre le PC dans le même sous réseau que le DBMseries, et ensuite changer l'IP du DBMseries. Pour cela, reportez-vous à la procédure décrite en annexe, dans "outils techniques".

#### C - Perte de l'adresse IP :

Si vous avez changé l'adresse IP du DBMseries et que vous l'avez perdue, alors il est possible de la retrouver en suivant la procédure suivante.

Appuyez pendant une seconde sur l'interupteur **8** (sur le côté de l'afficheur) noté IP CONTROL, l'adresse IP s'affichera alors sur les afficheurs en face avant.

Si vous appuyez pendant plus de 5 secondes , l'adresse IP revient à l'adresse de départ usine soit 192.168.0.122

#### PLAGE DE MESURE

En pondération A, la plage de mesure des niveaux sonores est de 60 dB(A) à 120 dB(A).

En pondération C, la plage de mesure des niveaux sonores est de 70 dB(C) à 130 dB(C).

## LISTE DES ERREURS

Liste des erreurs pouvant être affichées sur l'afficheur central (B).

- **E2:** Défaut liaison capteur.
- E3: L'intégralité de l'horloge interne de l'afficheur n'est plus garantie. Veuillez la resynchroniser avec l'horloge du PC

Synchronisation de l'horloge de l'afficheur avec celle du PC: dans le serveur web, allez sur Configurations -> Clock setting puis cliquez sur Sync & Save .



**DBMx03i real time clock:** Date et heure de l'horloge interne de l'afficheur

**Computer real time clock:** Date et heure de l'ordinateur connecté

**Synch&Save**: Cliquez sur ce bouton afin de synchroniser la date et l'heure du DBM à la date et l'heure du PC.


(Il est préférable de synchroniser son PC sur l'horloge parlante ou sur le web avant cette étape).

Si l'erreur E3 persiste, alors le niveau de la pile interne est faible, veuillez la remplacer, puis effectuez la synchronisation.

La mise à jour de l'afficheur DBMseries s'effectue en deux étapes :

A - Dans un premier temps, connectez-vous sur le serveur web. Pour cela, brancher un câble réseau (RJ45) sur la face arrière de l'appareil jusqu'à votre PC. Entrez l'adresse IP: 192.168.0.122 (Paramètre d'usine) sur votre navigateur Internet. Vous arrivez sur le serveur web.

Allez dans l'onglet "Reboot & Update", puis "Mise à jour du Serveur".



Entrez le "Nom d'utilisateur" et le "Mot de passe", puis diquer sur "Ok".

Paramètres d'usine : Nom utilisateur : admin Mot de passe : 0000

Cliquez sur le bouton "Parcourir..." pour récupérer le fichier "Weblmg. bin" que nous vous avons transmis.

Puis cliquez sur le bouton "Update". Le téléchargement s'effectue.

Pour s'assurer que la mise à jour soit effectuée, une fois sur la page "Accueil", vérifiez si la "Version Serveur" correspond au nom de la version que nous vous avons transmis.

**B** - Dans un deuxième temps, veuillez éteindre l'appareil. Introduisez, dans le connecteur USB A situé sur le côté droit de l'appareil, une clé USB préalablement chargée du fichier "DISPLAY.hex" fourni.



Pour effectuer le téléchargement de la mise à jour appuyez, à l'aide d'un outil pointu, sur le bouton "IP control" situé sur le côté de l'appareil, et rallumez votre appareil en gardant le bouton "IP control" appuyé jusqu'au démarrage de l'appareil.

L'afficheur passe en mode "Mise à jour" et affiche les lettre "BO" en bleu.

Une fois le téléchargement terminé, la couleur de l'affichage devient verte.

#### CARACTERISTIQUES

DBMseries: Sonomètre intégrateur

Pondération A : Classe 2 selon la norme IEC61672-1 de mars 2014. Pondération C : Classe 2 selon la norme IEC61672-1 de mars 2014.

Alimentation Courant Continu: 12 Volts, 700mA

Dimensions DBMseries : 265 x 150 x 35 mm Dimensions DBM403i Mobil : 265 x 150 x 110 mm

Poids DBMseries: 2 kg (DBMx03i+Capteur+Support mural)

Poids DBM403 Live: 3,100 kg

## **Code Usine**

Identifiant : **admin** Mot de passe : **0000** 

#### **INFORMATIONS**

## Attention !!!

Ne jamais faire fonctionner cet équipement sans le raccordement à la terre.

Assurez-vous de la qualité de la terre avant la mise en route.

Ne jamais démonter l'équipement, sans avoir pris la précaution de débrancher le cordon d'alimentation.

Eviter l'exposition à de trop fortes températures.

Ne jamais exposer l'alimentation et l'appareil à la pluie, la neige ou à l'humidité.

Ne pas obstruer les ouïes d'aération.

La gamme DBM series est conforme aux normes suivantes :

EN60065, EN55013, EN55020, EN60555-2, et EN60555-3, d'après les dispositions de la directive 73/23/EEC, 89/336/EEC et 93/68/EEC.

Les parties décrites en paragraphes A, B et C sont accessibles sans mot de passe.Il faut juste connaître l'adresse IP du DBM, en cas de perte ou d'oubli, voir C page 31.

## A - Le menu principal

#### Home



Pour sélectionner l'aide en anglais —

Cette page contient l'ensemble des informations de l'appareil.

#### System status:

Indication du modèle du DBMseries, son numéro de série, sa version....

Masked code: en nous faisant parvenir ce code de récupération, nous serons à même de vous communiquer votre mot de passe.

Battery status: Etat de la pile de sauvegarde de l'heure. Si la pile est défectueuse, l'afficheur affiche "E3"; il est alors nécessaire de la remplacer.

**Display setting:** Indication de la pondération A ou C et de la valeur du Leq pour les trois afficheurs

#### **B** - Visualisation du Leq

Visualisation en temps réel des leg : LAeg1s,LAeg15min, LCeg1s,LCeg15min

## Leq display for browser



## Leq display for Fullscreen



Choix du Leq à visualiser

Leq1s Leq1min Leq5min Leq10min

Leq15min Leq60min

## Remarque:

- F11 sur le clavier affiche la page en plein écran.
- F11 de nouveau permet de

INTERFACE WEB

Cette page appelée "Leq fullscreen", permet d'afficher en plein écran le niveau de trois Leq (par exemple LAeq1s, LAeq15min et LCeq15min). Elle est optimisée pour fonctionner sur un écran Full HD (1920x1080).


- Le choix du Leq pour chaque afficheur est 1s, 1min,5min,10min,15min et 60min.
- La couleur d'affichage peut être évolutive suivant le niveau.
- Les seuils de changement de couleur sont les mêmes que pour l'affichage led du DBMseries, Alarm I Threshold et Alarm 2 Threshold.
- Le Bargraph sur le côté droit est un indicateur prédictif de tendance basé sur le Leq 1min, avec des niveaux allant de -6dB à +6dB. C'est le reflet de l'indicateur situé à gauche de l'afficheur DBMseries. Les niveaux pris en compte en A et en C sont ceux programmés sur le web serveur Leq Limit Manager. Ils sont rappelés en bas à gauche de l'écran fullscreen: Limit:xxxdBC/xxxdBA. Le niveau qui est pris en compte comparativement entre le A et le C est celui des deux qui est prépondérant.

La couleur d'affichage peut être évolutive suivant le niveau.

## C - Historique : le téléchargement des données

Le DBMseries (DBM303i, DBM403i et DBM403i Mobil) propose le téléchargement des données dans trois formats différents : en HTML (excel, numbers) et CSV (texte), TXT.

SONECTRA

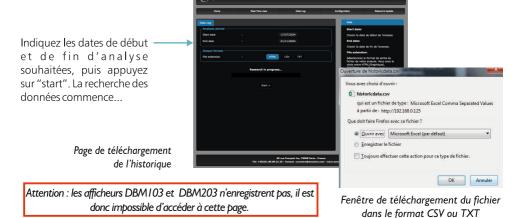

Le format HTML permet de générer une page web de l'historique avec des graphiques de chaque "Leq" enregistré. L'impression s'effectue directement avec la fonction "imprimer" de votre navigateur internet favori (Fichiers->Imprimer).



Le DBMseries permet aussi le *téléchargement* de l'historique sur *clé USB* en format CSV (Excel, number) Voir **9** page 21 pour la manipulation.

Suite

INTERFACE WEB

## D - Menu de configuration

La modification des paramètres dans ce menu de configuration est protégée par un mot de passe (sauf pour l'authentification). En sortie d'usine, le mot de passe de l'afficheur est 0000. Pour des raisons de sécurité, il est conseillé de modifier ce code d'accès avant de configurer tous vos paramètres. Vous pouvez néanmoins conserver ce code usine si vous le désirez.

Un mot de passe est nécessaire (code 0000 sortie usine) pour accéder à cette partie du serveur.



Pop-up de demande d'authentification. La configuration d'usine est :

Suite

Utilisateur : adminMot de passe : 0000

#### **Authentification**



#### Changement du mot de passe :

Ce mot de passe permet d'accéder aux pages de configurations.

Si vous avez oublié ce code, il suffit de nous communiquer le code masqué correspondant, afin que nous puissions vous donner le mot de passe.

#### **Correction & limit**



#### Weighting A measurement correction:

Reference level: Le niveau acoustique à l'endroit où le public est le plus exposé.

Sensor level:

Le niveau acoustique au niveau du capteur. Ce réglage est particulièrement important pour une visualisation fiable des niveaux sonores. En effet, le niveau du capteur, si celui-ci est placé près d'une enceinte acoustique, sera plus élevé que celui du public. La différence entre ces deux niveaux est appelée soit par le terme d'offset, soit plus souvent par le terme de fonction de transfert.

Comment le déterminer : De façon très simple, il suffit de diffuser un niveau acoustique (quel que soit ce niveau) en bruit rose sur la sonorisation, et avec votre sonomètre en pondération A vous mesurez :

- Le niveau acoustique global au niveau du capteur par exemple 98 dB
- Le niveau acoustique global au niveau du public par exemple 93 dB

Il suffit de rentrer ces deux valeurs pour que l'afficheur calcule automatiquement la différence et indique les niveaux sonores corrigés pour le public. La plage de mesure de 60 dB est conservée.

## Weighting C measurement correction:

Il faut effectuer la même manipulation avec votre sonomètre en pondération C .

Si l'équilibre spectral est identique au niveau du capteur et au niveau du public, vous pouvez rentrer les mêmes valeurs que pour la pondération A.

## Leq Limit Manager:

Indiquez le niveau de référence qui doit être pris en compte pour l'indicateur prédictif de tendance basé sur le leq 1 min. Voir descriptif en page 9, référencé A.

Si par exemple les niveaux sonores sont limités à 102 dBA et 118 dBC sur un Leq15 min (nouveau décret), vous pouvez rentrer ces valeurs de niveaux pour le A et pour le C.

L'indicateur prédictif basé sur 1 min vous sera très utile pour anticiper un dépassement sur 15 min.

## Display setting:



Cette page permet de configurer pour chacun des trois afficheurs les seuils des niveaux sonores indiqués Alarm I Threshold et Alarm 2 Threshold.

Les trois afficheurs ont la possibilité de changer de couleur en fonction des niveaux sonores et en fonction des niveaux que vous allez programmer.

La couleur de base va changer une première fois en fonction du seuil indiqué à *Alarm I Threshold* puis une deuxième fois en fonction du seuil indiqué à *Alarm 2 Threshold*.

Voir page suivante pour le choix des couleurs . Vous pouvez désactiver cette fonctionnalité en éteignant le bouton *Enable*, en face de chaque alarme.

## Color setting:



C'est la page de colorimétrie du DBMseries. Quatre presets vous permettent un choix rapide des couleurs.

Le mode custom vous permet de choisir in dépendamment pour chaque afficheur la couleur de base *Value*, le changement de couleur pour les deux dépassements *Alarm1* et *Alarm2* et la couleur des unités de mesure *Unit*.

De même il est possible de choisir les deux couleurs hautes et basses pour l'indicateur prédictif de tendance Leq Limit Manager Less et Over.

La partie *Brightness* (indépendamment des presets) permet d'ajuster la luminosité des afficheurs en manuel ou en automatique (cellule photo sensible permettant d'adapter la luminosité en fonction de la lumière ambiante).

Pour permettre une meilleure visibilité des valeurs numériques, il est possible d'atténuer la luminosité desUnités de mesure, *UnitDimming*.

## **Control setting**



#### Identification:

Cette partie permet de renseigner le site et la localisation particulière sur le site. (cas de complexe multi salles )

Ces deux informations seront reprises dans le journal d'événements et les historiques de niveaux.

#### **Test Measuring chain:**

Le capteur MIC102 est doté d'un haut-parleur piezo pour pouvoir tester l'intégrité acoustique du microphone. Il faut calibrer cette chaîne à l'installation. *Run Process*.

Ce test se fera ensuite à chaque mise en route et de façon aléatoire. En cas de défaut ,un message sera intégré dans l'historique.

Si le capteur, comme le MIC204, ne dispose pas de cette fonctionnalité, il faut désactiver ce test automatique, en éteignant le bouton *Enable*.

#### **General Purpose Output I/ General Purpose Output 2:**

Le connecteur RJ45 de sortie GPO1/ GPO2 dispose de deux sorties relais basse tension pour pouvoir connecter différents éléments complémentaires (Gyrophare, avertisseurs), voir 5 page 20.

C'est cette sortie qui permet aussi de relier et d'alimenter les afficheurs figuratifs AMIseries.

Ces deux relais GPO1 et 2 sont programmables à la fois en niveau acoustique, en pondération A ou C et en Leq 1s,1min,5min,10min,15min ou 60 min.

#### **Email Alerts setting**

Cette page permet de configurer 3 types d'alarme : E-mail Alert 1 ; E-mail Alert 2 ; E-mail Alert 3



Sur chaque alarme on peut programmer:

**Reference:** Le leq référent soit : leq 1s,1min,5min,10min,15min et 60min.

**Weighting A/Weighting C:** La pondération A ou C.

**Threshold:** Le seuil de déclenchement de l'alarme en dB

Alert Delay: Le temps de retard entre le moment ou un dépassement est détecté et le temps ou une alarme est générée.

**Repetition in Hour:** Nombre d'alertes dans l'heure avant l'envoi d'un E-mail d'information

E-mail Alert Time slot: Possibilité de définir la plage horaire pour l'envoi d'un E-mail d'information.

#### **Email server**



#### **SMTP** setting:

SMTP server: nom effectif du serveur SMTP

Port: Port de communication du serveur SMTP

User Name&Passeword: saisir vos identifiants si le serveur SMTP nécessite une authentification

Message: texte personnalisable inscrit dans le corps de l'Email envoyé.

#### Alerts routing:

L'équipement peut envoyer des E-mails à trois adresses différentes.

E-mail Address: Renseignez ces trois adresses ou moins si vous le souhaitez.

Routing: Affectez une ou plusieurs alarmes à chaque adresse mail.

#### **Test SMTP setting:**

Send test message: Permet le test d'envoi de message E-mail avant de valider par SAVE

## **Clock setting**



**DBM403i real time clock:** Date et heure de l'horloge interne de l'afficheur

**Computer real time clock:** Date et heure de l'ordinateur connecté

**Synch&Save :** Cliquez sur ce bouton afin de synchroniser la date et l'heure de l'AFF à la date et l'heure du PC.

**DST**: Daylight saving time : Sélection du mode de changement de l'heure été/hiver, en automatique ou en manuel.

## **SNTP Setup:**

SNTP Server: Adresse IP ou nom DNS

**Time zone:** Fuseau horaire correspondant à l'heure locale. Soit +1 pour la France.

Interval: Période de synchronisation SNTP: De jamais jusqu'à 24 H. Off/1h/12h/24h

## **Network setting**



N'oubliez pas de valider vos paramètres en cliquant sur SAVE

#### Identification:

Hostname: C'est le nom de l'équipement sur le réseau par exemple DBM403i.

MAC address: (Media Access Control) C'est un identifiant physique stocké et unique, pour identifier les numéros des équipements et le fabricant.

INFO: Par exemple pour EC:D9:25:01:1C:94, Le premier groupe en hexa décimal EC:D9:25 est l'identifiant donné par l'instance internationale pour les fabrications Rami et AMIX, le dernier groupe 11C94 est la conversion en Hexa décimal du numéro de série 72852

#### Use the following IP address:

IP address: L'adresse IP de sortie usine est 192.168.0.122, si vous voulez modifier cette adresse, cliquez directement dans la case et modifier les chiffres.

Vous choisissez une IP fixe à attribuer à l'afficheur. Elle doit se trouver dans le même sous réseau que votre routeur.

Exemple I: si IP routeur est 192.168.1.1 alors IP DBM sera: 192.168.1.xxx (xxx est compris entre 2 et 254)

Exemple 2: si IP routeur est 192.168.0.1 alors IP DBM sera: 192.168.0.xxx (xxx est compris entre 2 et 254)

#### Attention:

- l'IP doit être unique dans le sous réseau.
- Après avoir changé l'adresse IP, n'oubliez pas de taper la nouvelle adresse IP du DBM dans la barre d'adresse, puis appuyez sur Save.

Subnet mask: C'est le masque de sous-réseau dans lequel l'appareil se trouve.

Default gateway: Entité logique qui permet de relier deux réseaux informatiques.

**DNSSERVER:** DNS (Domaine Name Service), service permettant de traduire un nom de domaine

en information

Slave mode: Permet de télécharger et de dupliquer sur cet DBM esclave, la réplique de l'affichage

d'un DBM maître. Fonction disponible à partir de la version 1.9 inclus.

Enslave Display: Enable pour appeler cette fonction et Disable pour la retirer.

Server IP Address: Indiquez ici l'adresse IP du DBM maître à dupliquer.

Attention on ne peut pas avoir plus de trois afficheurs en mode esclave à partir d'un afficheur (ou d'un limiteur) maître.

#### Sensor calibration



#### Sensor calibration:

Cette page vous permet de recalibrer la chaîne de mesurage du DBMseries. Cette manipulation est à effectuer tous les deux ou trois ans. Il faut disposer d'un calibreur qui accepte les micros de mesure ½ pouce. Il faut prêter une attention particulière à la qualité de ce calibreur et la conformité par rapport à la norme NF EN/CEI 60942. Il faut choisir de préférence un calibreur spécifié classe 1, en effet il faut toujours mieux choisir pour un calibrage un élément de classe supérieure à l'équipement.

Mettre sous tension l'afficheur et attendre 15 min pour atteindre la stabilisation thermique des éléments internes.

Introduire le calibreur dans le capteur et lancer l'émission sonore 94 dB.

Vous pouvez alors visualiser sur la page :

Level Weight A: Le niveau de la chaîne en pondération A qui doit être proche de 94.

Level Weight C: Le niveau de la chaîne en pondération C qui doit être proche de 94.

Level peak: Le niveau de la chaîne en pondération C et en niveau crête qui doit être proche de 97.

Lorsque vous visualisez ces niveaux vous pouvez lancer la calibration par Start Calibration

Dans le cas où les niveaux seraient supérieurs ou inférieurs de 2dB, la calibration est annulée et le message suivant apparaît : Error, the sensor calibration it's over limits +/- 2dB

La dérive de l'ensemble capteur + Afficheur étant très faible, il faut vérifier le calibreur avec un sonomètre.

En cas de doute après calibration, pour revenir à la calibration usine cliquez sur : Restore Factory calibration

## Import/Export setting



#### Webserver update



## **Factory setting**



#### File import:

Il est possible d'importer un fichier de configuration déjà sauvegardé, pour l'installer dans l'appareil.

Ceci est particulièrement utile si vous voulez reprogrammer votre afficheur en fonction du type de spectacle.

Par exemple spectacles pour enfants avec les limites de niveaux qui leur correspondent.

#### File export:

Une fois la configuration de votre appareil terminée, vous pouvez sauvegarder cette dernière en exportant le fichier et en le sauvegardant dans votre PC.

Le nom du fichier peut être modifié pour un stockage des configurations simplifiées ex: "DBM403 PARIS.conf".

Cette page permet de mettre à jour le serveur web de l'afficheur :

MPFS Image download: Sélectionnez le fichier .Bin que vous avez reçu ou téléchargé sur notre site et cliquez sur Update.

Si vous devez aussi mettre à jour le logiciel machine, c'est un fichier .Hex vous devez le charger sur une clé USB, voir en **9** page 21 pour la procédure.

Cette page permet de recharger les paramétres d'usine du DBMseries. Cliquez sur *Restore*.

## Reboot



Ce menu vous permet de redémarrer votre équipement. En cliquant sur "reboot", l'écran ci-dessous apparaîtra :



Pour fonctionner correctement, l'adresse IP du DBM doit être d'une part unique dans le sous réseau, et d'autre part elle doit appartenir à la plage d'adresse IP disponible.

## Procédure pour l'installation:

Si le PC ou le routeur, sur lequel le DBM sera branché, est dans un autre sous réseau (ex: 192.168.1.14 avec masque de sous réseau 255.255.255.0) il faudra mettre le PC dans le même sous réseau que le DBM, et ensuite changer l'IP du DBM. Pour cela:

## SOUS WINDOWS 10

- I. Faire un clic droit sur l'icône du réseau en bas à droite de l'écran et choisir "Paramètres réseau & Internet", ou aller dans menu Démarrer, Paramètres, Réseau et Internet, Ethernet, Modifier les options d'adaptateur.
- 2. Double cliquer sur la carte réseau en question (Ethernet ou Wi-Fi).
- 3. Dans la fenêtre "Etat de l'Ethernet" ou "Etat du Wi-Fi", cliquer sur le bouton "Propriétés"
- **4.** Double cliquer sur la ligne "Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)" puis sur "Propriété":

Cliquez sur l'option "Utiliser l'adresse IP suivante:" et fixez une adresse IP dans le même sous réseau que le DBMseries (ex : 192.168.0.29).

Cliquez sur OK puis de nouveau OK.

 $Votre \, adresse \, IP \, est \, maintenant \, fixe. \, Vous \, pouvez \, d\'esormais \, acc\'eder \, \grave{a} \, I' \, Afficheur \, via \, un \, navigateur \, web. \, desormais \, acc\'eder \, \grave{a} \, I' \, Afficheur \, via \, un \, navigateur \, web. \, desormais \, acc\'eder \, \grave{a} \, I' \, Afficheur \, via \, un \, navigateur \, web. \, desormais \, acc\'eder \, \grave{a} \, I' \, Afficheur \, via \, un \, navigateur \, web. \, desormais \, acc\'eder \, acc$ 

⇒ Si vous utilisez votre afficheur en autonome, vous pouvez maintenant visualiser les pages web, qui vous permettront de configurer, d'analyser et de consulter sa mémoire interne.

En sortie d'usine l'adresses IP des afficheurs DBMseries est:



⇒ Si vous utilisez votre afficheur en réseau, vous devez poursuivre cette procédure :

Dans le menu "Configuration IP" du serveur web, choisissez une adresse IP dans la plage d'adresse IP disponible dans le sous-réseau de destination (réseau dans lequel le DBMseries sera installé).

#### Exemple:

IP routeur: 192.168.1.1 IP DBMseries: 192.168.0.122

Si le masque de sous réseau du routeur est 255.255.0, le DBMseries sera en dehors des adresses IP disponibles dans ce sous réseau . Changez l'adresse IP du DBMseries par une adresse à l'intérieur du sous réseau (ex: 192.168.1.122).

Vous pouvez maintenant connecter le DBM series au routeur de destination.

Le PC utilisé pour exécuter cette procédure ne sera plus dans le sous réseau, veillez à le remettre dans sa configuration d'origine .

Ouvrez votre navigateur web, tapez l'adresse IP du DBMseries dans la barre d'adresse, puis appuyez sur entrée.



Vous pouvez maintenant visualiser les pages web, vous permettant ainsi de configurer, d'analyser et de consulter la mémoire interne du DBMseries.



60 rue François 1er 75008 PARIS - FRANCE

Tél.: +33 (0)1 85 09 21 25 Mail: sonectra@sonectra.com

www.sonectra.com